

AGNUS
BRASIL

Processo nº 270
Processo nº 028/2024
Rubrica:

ENVELOPE Nº 01

Proposta de Preços

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024-PMC

Prefeitura Municipal de Carolina

Data: 21.06.2024

Hora: 08h30min

AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 34.700.478/0001-46

Processo n° 477
Processo n° 0261204
Fabrica:



PROPOSTA

A handwritten signature consisting of several overlapping loops.

A collection of handwritten signatures and initials, including a large stylized 'A' at the top, and several other scribbled marks below it.



PROPOSTA COMERCIAL

Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carolina
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024-PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024-PMC

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	
CNPJ	34.700.478/0001-46	
INSCR. ESTADUAL	797519439118	
INSCR. MUNICIPAL	20117274	
FONE/FAX	(016) 3235-6102	
E-MAIL	licitacao@agnusbrasil.com.br	
ENDEREÇO	Rua Guido Zampolo, 386 – Recanto das Flores - Ribeirão Preto – SP CEP: 14110-000	
DADOS BANCÁRIOS	Favorecido: AGNUS BRASIL COM. SERV ARTIGOS LAB. EIRELI CNPJ: 34.700.478/0001-46 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) Agência: 3188 Conta Corrente: 108.225-6	
REPRESENTANTE LEGAL inclusive para assinatura do contrato e outros documentos inerentes: Sra. Natália Bernichi Gandini Bianco, maior, capaz, nacionalidade: Brasileira, casada, biomédica, nascido(a) em: 25/08/1981, filho de Maria Stela Bernichi Gandini e Sérgio Luiz de Sousa Gandini, portador(a) do RG: 34.436.458-6, expedido por: SSP-SP, inscrito no CPF sob o No. : 297.249.258-70, Residente à AV. Angelo Antonio Colafemina, 350 – Cond. Santa Angela – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.110-000		
TEL: (16) 3635-6102	FAX:(16) 3635-6102	e-mail: licitacao@agnusbrasil.com.br

1. A empresa **AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **34.700.478/0001-46**, com sede na **Rua Guido Zampolo, 386 – Recanto das Flores - Ribeirão Preto – SP CEP: 14110-000**, representada por sua **Representante legal, Sra. Natália Bernichi Gandini Bianco, RG: 34.436.458-6, expedido por: SSP-SP, inscrita no CPF sob o No. : 297.249.258-70, DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024-PMC**, especialmente a Lei nº 14.133/2021, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

2. Propomos o valor total de **R\$ 162.000,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil Reais)** para o Registro de Preços para fornecimento de **EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS**, objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à **Prefeitura Municipal de Carolina**, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024-PMC**, obedecendo as especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

- cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

3. O prazo de validade desta Proposta é de **90 (Noventa) dias consecutivos** a contar da data da sua entrega.



AGNUS BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E.: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102



4. Comprometemos a entregar os **Equipamentos** no prazo máximo de **10 (dez) dias**, a contar da data do recebimento da **Ordem de Fornecimento**.

5. Comprometemos a entregar os **Equipamentos no almoxarifado** da

a) **Secretaria Municipal de Saúde;**

a.1) Endereço: **Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**

6. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, devidamente atestado pelo **Gestor do Contrato**, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;

b) cópia da Nota de Empenho;

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;

f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;

g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Qty Unid	MARCA MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA – 3 partes Diff de última geração.</p> <p>PARÂMETROS: Análise de 27 parâmetros – sendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contagem total de leucócitos (células brancas) - (WBC / GB). 2. Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos) - (RBC / GV). 3. Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) - (HGB concentração). 4. Determinação hematócrito (HCT). 5. Determinação de volume corpuscular médio do tamanho das células (MCV / VCM). 6. Determinação da hemoglobina corpuscular média (MCH / HCM). 7. Concentração da hemoglobina corpuscular média - (MCHC / CHCM). 8. Determinação do índice de anisocitose (RDW-SD). 9. Contagem total de plaquetas (PLT). 10. Contagem total de plaquetócitos (PCT). 11. Determinação do volume plaquetário médio (MPV / VPM). 12. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas – desvio padrão (PDW-SD / ADP-SD). 13. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas – coeficiente de variação (PDW-CV / ADP-CV). 14. Contagem de linfócitos, valor absoluto (LYM#). 15. Porcentagem de linfócitos, valor relativo (LYM% / LYMPH). 16. Coeficiente de variação amplitude distribuição glóbulos vermelhos (RDW-CV / ADVG-VC). 17. Taxa de células grandes e plaquetas (P-LCR). 18. Contagem de células grandes (P-LCC). 19. Contagem de células de tamanho médio (eosinófilo, basófilo, monócito) - (MID# / N°MÉD). 20. Porcentagem de células de tamanho médio (MID% / %MÉD). 21. Contagem total de granulócitos (neutrófilos) - (GRAN# / N°GRAN). 22. Porcentagem de granulócitos (GRAN% / %GRAN). 23. Razão neutrófilo-linfócito (Neutrophil-to-lymphocyte ratio) (NLR / RNL) 24. Razão plaqueta-linfócito (Platelet-to-lymphocyte ratio) (PLR / RPL) 25. Histograma WBC; 26. Histograma RBC; 27. Histograma PLT. <p>VELOCIDADE: Capacidade de 70 amostras/hora.</p> <p>AMOSTRAS/ IDENTIFICAÇÃO: Sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído, com diluição automática integrada. Identificação alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis.</p> <p>ASPIRAÇÃO/AMOSTRA: Análise de amostras em tubos abertos com aspiração já a partir de 9µl de amostra.</p> <p>REAGENTES: Apenas 2 reagentes com sensor de nível.</p>	01 und	SINSENG Modelo: MAX S-3	R\$ 68.800,00	R\$ 68.800,00





283
Processo nº 02862024

	<p>SISTEMA/MÉTODOS: Impedância e Colorimetria para dosagem de hemoglobina. Reagente sem cianeto para medição de HGB</p> <p>LIMPEZA: Limpeza automática – interna e externa da agulha de aspiração - remoção de obstrução.</p> <p>CALIBRAÇÃO: Automática com opção de manual.</p> <p>HISTOGRAMAS: 3 Histogramas (WBC/RBC/PLT)</p> <p>ALARMES: Múltiplas sinalizações inteligentes com alertas para valores anormais ou referência e para falhas de contagem - nas séries vermelha e branca e, também de plaquetas, com função de recontagem;</p> <p>IMPRESSORA: Acompanha impressora para resultados e de 3 histogramas: série vermelha, série branca e plaquetas;</p> <p>PORTAS / INTERFACE: 4 Portas USB, 1 porta LAN-Ethernet e RS232, permitindo Interface, incluindo gráficos e matriz.</p> <p>MONITOR: Tela Touchscreen 10.4"</p> <p>LEITOR CÓDIGO DE BARRAS: Porta dedicada para leitor de código de barras.</p> <p>MEMÓRIA: Capacidade para 100.000 resultados de pacientes, incluindo histogramas e calibração para mais de 200 arquivos de controle de qualidade. Levey-Jennings, X-B, X-R.</p> <p>ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V – 240V ~; 50/60 Hz.</p> <p>Acompanha Nobreak, e kit inicial de diluente, lisante, detergente e controle para instalação do equipamento e treinamento aos operadores.</p> <p>Instalação e treinamento in loco inclusos no valor proposto.</p> <p>Marca: SINSENG - Modelo: MAX S-3</p> <p>Fabricante: Shezen Sinseng Medical Technology Co., Ltd.</p> <p>Garantia de 12 meses;</p> <p>Registro ANVISA/MS: 81452980014</p>				
02	<p>ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO: com velocidade de pipetagem de 200 testes fotométricos por hora;</p> <p>Até 72 posições simultâneas para reagentes, com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa;</p> <p>60 posições simultâneas de cubetas de reação; Sistema automático que lava e seca as cubetas de incubação para reação;</p> <p>50 posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitam o uso de "micro tubos" ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles;</p>	01 Unid.	SINNOWA Modelo: SX-160	R\$ 93.200,00	R\$ 93.200,00





AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

Processo nº 282
028/2024

<p>Possui sensor na agulha pipetadora de amostras /reagentes, que indica com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes;</p> <p>A agulha pipetadora possui sensor anti-impacto que evita a quebra da mesma em caso de toque em local indevido.</p> <p>Aceita amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomará a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática;</p> <p>Possui Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória.</p> <p>Permite interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português;</p> <p>Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas;</p> <p>Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática;</p> <p>Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade incluindo gráfico de Levey-Jennings e Regras de Westgard;</p> <p>A seringa de pipetagem é confeccionada com embolo/estoper em cerâmica de alta resistência, possibilitando precisão de aspiração a partir de 1µL de amostras;</p> <p>Possui filtros de onda com 10 comprimentos de onda diferentes, abrangendo o range de 340 até 800nm, Com possibilidade de adicionar mais 2 a escolher;</p> <p>Sistema totalmente "aberto" com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para 200 programações de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente;</p> <p>Acessórios: Deionizador de água, CPU (computador operacional); monitor, mouse, teclado e nobreak adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS. A empresa vencedora deverá instalar o equipamento no laboratório e fornecer treinamento aos operadores. Bem como fornecer kit inicial de reagentes, calibradores e controles para a instalação e treinamento.</p> <p>VOLTAGEM: Bi-Volt (100~240v) - automático Garantia de 12 meses;</p> <p>MARCA: Sinnowa – Modelo: SX160</p> <p>Registro ANVISA/MS: 81452980003</p>				
---	--	--	--	--

Total da Proposta = R\$ 162.000,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil Reais)



R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP. Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102



AGNUS COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA
BRASIL

Processo nº 283
028/2024

Ribeirão Preto, 21 de junho de 2024

Agnus Brasil Com . Serv. Artigos Laboratoriais LTDA

CNPJ: 34.700.478/0001-46

Hamilton Bianco

CPF: 127.29.658-45 / RG 16.753.100-1

Representante Legal

34.700.478/0001-46
AGNUS BRASIL COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ARTIGOS
LABORATORIAIS LTDA
Rua Guido Zampolo, 386
Distrit.de Bonfim Paulista-Recanto das Flores
CEP14110-000
RIBEIRÃO PRETO - SP




AGNUS
BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102

ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

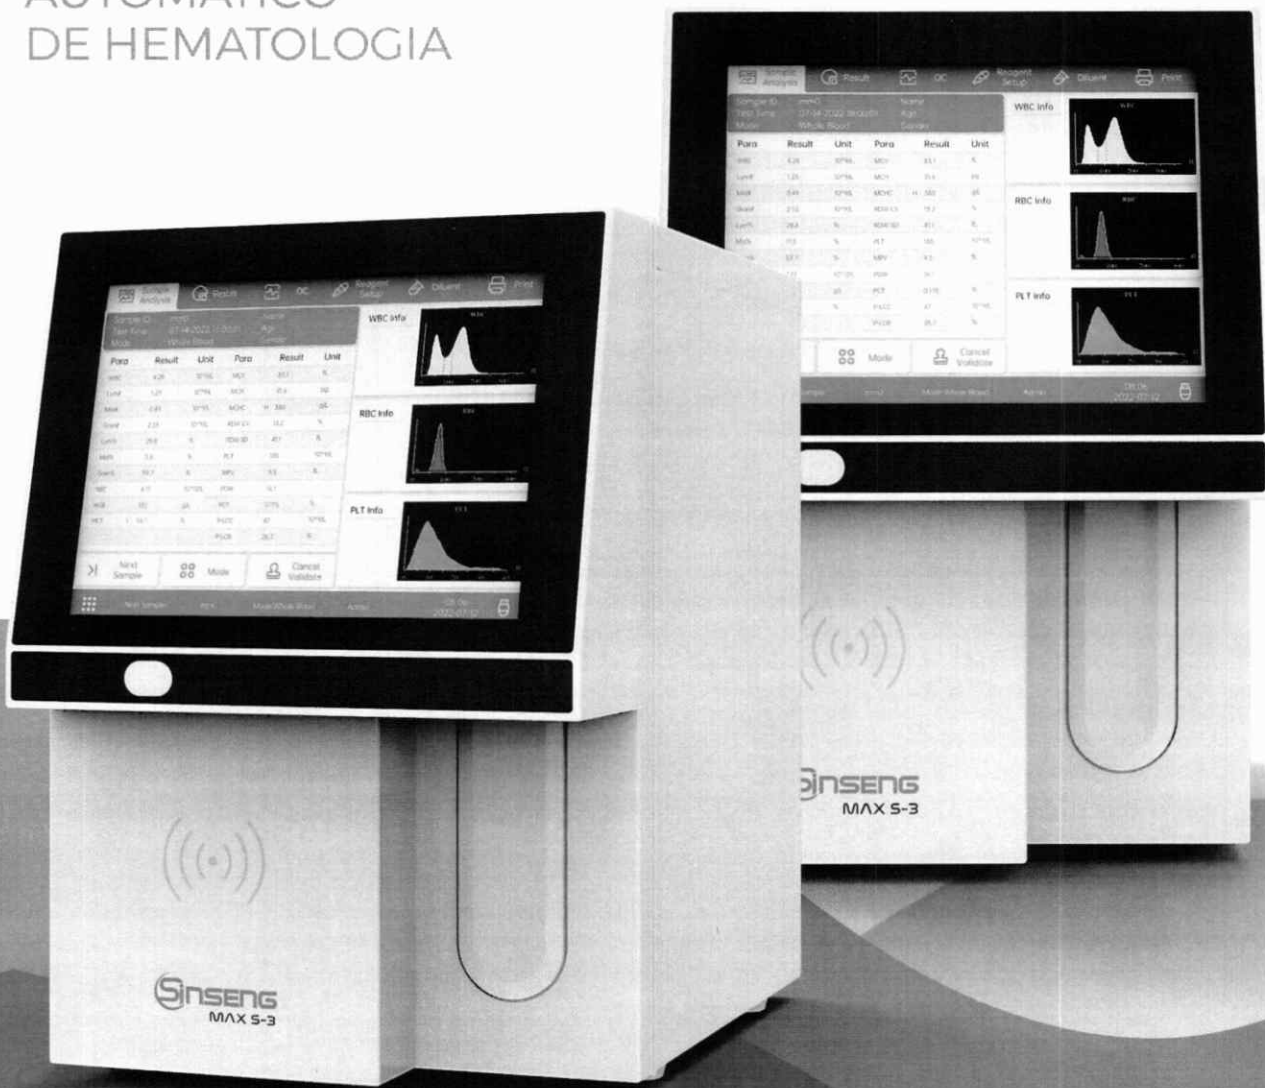

MAX S-3

3 partes diff

- ✓ 70 testes por hora
- ✓ ≤9uL de amostra por teste
- ✓ 27 parâmetros reportáveis com 3 histogramas

- ✓ 10.4" touch screen ou 14" (opcional)
- ✓ Apenas 2 reagentes
- ✓ Menor custo de manutenção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SINSENG

Nota nº 285
Processo nº 028/2024
Subvenc:

PARÂMETROS

Descrição	Abreviações
1. Contagem total de leucócitos (células brancas)	WBC / GB
2. Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos)	RBC / GV
3. Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina)	HGB concentração
4. Determinação hematócrito	HCT
5. Determinação de volume corpuscular médio do tamanho das células	MCV / VCM
6. Determinação da hemoglobina corpuscular média	MCH / HCM
7. Concentração da hemoglobina corpuscular média	MCHC / CHCM
8. Determinação do índice de anisocitose	RDW-SD
9. Contagem total de plaquetas	PLT
10. Contagem total de plaquetócitos	PCT
11. Determinação do volume plaquetário médio	MPV / VPM
12. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas - desvio padrão	PDW-SD / ADP-SD
13. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas - coeficiente de variação	PDW-CV / ADP-CV
14. Contagem de linfócitos, valor absoluto	LYM#
15. Porcentagem de linfócitos, valor relativo	LYM% / LYMPH
16. Coeficiente de variação amplitude distribuição glóbulos vermelhos	RDW-CV / ADVG-VC
17. Taxa de células grandes e plaquetas	P-LCR
18. Contagem de células grandes	P-LCC
19. Contagem de células de tamanho médio (eosinófilo, basófilo, monócito)	MID# / N°MÉD
20. Porcentagem de células de tamanho médio	MID% / %MÉD
21. Contagem total de granulócitos (neutrófilos)	GRAN# / N°GRAN
22. Porcentagem de granulócitos	GRAN% / %GRAN
23. Razão neutrófilo-linfócito (Neutrophil-to-lymphocyte ratio)	NLR / RNL
24. Razão plaqueta-linfócito (Platelet-to-lymphocyte ratio)	PLR/RPL
25. Histogramas de glóbulos brancos	WBC
26. Histogramas de glóbulos vermelhos	RBC
27. Histogramas de plaquetas	PLT

Parâmetro	Range de Linearidade
WBC	$0 \times 10^9 / L - 200.0 \times 10^9 / L$
RBC	$0.00 \times 10^{12} / L - 8.00 \times 10^{12} / L$
HGB	20g/L - 250g/L
PLT	$0 \times 10^9 / L - 5000 \times 10^9 / L$



LCD TOUCH
SCREEN



FÁCIL
OPERAÇÃO



BAIXO
CUSTO




DADOS
PRECISOS

Características	Descrição
VELOCIDADE	Capacidade de 70 amostras/hora.
VOLUME DE AMOSTRAS	Análise de amostras em tubos abertos. Capaz de realizar testes com volume de aspiração de 9l. Aceita amostras de sangue total, capilares, sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído.
SISTEMA / MÉTODOS	Impedância e colorimetria para dosagem de hemoglobina. Reagente sem cianeto para medição de HGB. Sistema de dois canais de drenagem em sequência. Multi-distribuição das amostras para WBC e WBC+Diff.
LIMPEZA	Limpeza automática e programável, interna e externa da agulha de aspiração. Limpeza automática e programável do sistema.
CALIBRAÇÃO	Automática com opção de manual.
HISTOGRAMAS	3 histogramas para (WBC, RBC e PLT)
IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS	Alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis. Leitor de código de barras (opcional)
ALARMES	Múltiplas sinalizações inteligentes com alertas para valores anormais ou referência e para falhas de contagem nas séries vermelha e branca e, também de plaquetas, com função de recontagem.
IMPRESSORA	Acompanha impressora térmica interna, com possibilidade de adicionar externa.
PORTAS/INTERFACE	4 USB com opção RS232, 1 LAN Ethernet, permitindo Interface, incluindo gráficos e matriz.
SOFTWARE	Moderno, prático e intuitivo. 100% em português, com controle de qualidade (CQ) completo.
MONITOR	Tela touchscreen 10.4" colorida (com opcional para 14").
LEITOR CÓD. BARRAS	Porta dedicada para leitor de código de barras.
MEMÓRIA	Capacidade para mais de 100 mil resultados de pacientes incluindo gráficos (histogramas).
ALIMENTAÇÃO	Bi-volt automático. Tensão: 110 - 240V - 50/60Hz.
REGISTROS	Registro ANVISA/MS 81452980014 Fabricante: Shenzhen Sinseng Medical Technology Co., Ltd.

Ficha nº 286
 Processo nº 028/2024
 Data: 02/08/2024

DIMENSÕES E PESO



A	Altura:	396mm
B	Largura:	272mm
C	Profundidade:	420mm
	Peso:	19Kg

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Forma n° 287
Processo n° 028/2024
Rubrica:

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME
CNPJ	07.776.581/0001-05
Autorização	8.14.529-8
Produto	ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA MAX S-3

Modelo Produto Médico
MAX S-3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO SINSENG MAX S-3_2023_08.pdf	1043267239 - 02/10/2023 09:37:08

Nome Técnico	Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas
Registro	81452980014
Processo	25351575177202319
Fabricante Legal	SHENZHEN SINSENG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

25351.568647/2023-80 / 81972600009
8437 - IVD - Notificação de produtos em família Classe II / 0921223234

Ana Julia Martins Faleiros de Andrade Ltda. / 40.649.293/0001-57
Instrumentos Odonto - Médicos com Videa - Cooperflex
25351.613596/2023-58 / 82667650003
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0992846234

ANADONA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP / 69.348.936/0001-04
Avental Cirúrgico Estéril
25351.609291/2023-41 / 80175340009
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0986507237

ARGOSLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA / 09.377.976/0001-52
17-OH-Progesterone Saliva ELISA Free
25351.571973/2023-74 / 80464810853
80133 - IVD - Notificação de produto Classe II / 0926709232
IDK® Amino Extract
25351.571819/2023-01 / 80464810852
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0926545230

ARTHREX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 18.272.616/0001-87
Kits de Camisas para NanoNeedle Scope
25351.620395/2023-15 / 80978569019
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1004030231

BIOBLASTI INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIOMATERIAIS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA - EPP / 23.146.163/0001-82
Kit Bloqueio com Estimulo BBT
25351.565681/2023-01 / 81469209035
8024 - EQUIPAMENTO - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0912644231

BIOŠANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA / 06.143.681/0001-23
Extensor para Aspiração
25351.610459/2023-61 / 80286000049
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0987771230

BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / 10.972.948/0005-96
TORNEIRA 3 VIAS SAVEMED
25351.617092/2023-15 / 82681419002
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0998572233

CANADÁ CENTRAL DE NEGÓCIOS DO BRASIL LTDA / 01.911.022/0001-76
Ponta para Aspirador Cirúrgico Elmed
25351.610142/2023-25 / 80003890157
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0987425234
Kit Instrumental Cirúrgico Elmed
25351.610014/2023-81 / 80003890156
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0987291238

CHINA MEHECO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA / 37.338.619/0001-10
PROBE WASHING BUFFER / SOLUÇÃO DE LAVAGEM DE SONDAS - DIRUI
25351.571195/2023-13 / 82378830003
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0925860239
ACID TRIGGER REAGENT / REAGENTE DE ATIVAÇÃO ÁCIDA - DIRUI
25351.571190/2023-91 / 82378830001
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0925852236
ALKALINE TRIGGER REAGENT / REAGENTE DE ATIVAÇÃO ALCALINA - DIRUI
25351.571191/2023-35 / 82378830002
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0925853232
RBC FOLATE RELEASING AGENT / AGENTE DE LIBERAÇÃO DE FOLATO EM HEMÁCIAS - DIRUI
25351.571202/2023-87 / 82378830004
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0925873233
SAMPLE DILUENT / DILUENTE DE AMOSTRA - DIRUI
25351.571204/2023-76 / 82378830006
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0925875236
CONCENTRATED WASHING BUFFER / TAMPÃO DE LAVAGEM CONCENTRADO - DIRUI
25351.571205/2023-11 / 82378830007
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0925876232
PROBE CONDITIONING SOLUTION / SOLUÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE SONDA - DIRUI
25351.571203/2023-21 / 82378830005
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0925874230

CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA / 61.418.042/0001-31
Canula para punção para port de infusão Polymed
25351.617187/2023-21 / 10150479150
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0998687235

CLÍNICALTOOLS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 44.704.903/0001-29
SISTEMA DE ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PORTÁTIL
25351.565457/2023-19 / 82724499001
8024 - EQUIPAMENTO - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0912401231

DRÄGER DO BRASIL LTDA / 61.185.922/0001-05
HME HumidStar Trach Plus
25351.617460/2023-17 / 10303949023
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0998986232
HME HumidStar 2 Plus
25351.617502/2023-10 / 10303949024
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0999033239
HME HumidStar 25 Plus
25351.617064/2023-90 / 10303949021
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0998539236
HME HumidStar 55 Plus
25351.617164/2023-16 / 10303949022
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0998659231

EBD Biotech Importação e Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda / 13.977.106/0001-91
Família EBD BACT KIT ID/AST
25351.571682/2023-86 / 82206010010
8437 - IVD - Notificação de produtos em família Classe II / 0926396234
Família EBD BACT KIT ID/AST FUNGOS
25351.571809/2023-67 / 82206010011
8437 - IVD - Notificação de produtos em família Classe II / 0926535234
Família Instrumentos EBD BACT ID/AST

25351.571681/2023-31 / 82206010009
8437 - IVD - Notificação de produtos em família Classe II / 0926395238

ECCO FIBRAS ÓPTICAS E DISPOSITIVOS LTDA - EPP / 01.644.138/0001-96
ILUB 4.0
25351.338206/2023-55 / 80323319003
8024 - EQUIPAMENTO - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0547026234

Enzytec Biotecnologia Ltda. / 07.214.566/0001-65
Teste de gravidez HCG (urina) (ouro coloidal)
25351.571926/2023-21 / 82444370071
80133 - IVD - Notificação de produto Classe II / 0926660233
Teste de Gravidez HCG (ouro coloidal)
25351.568611/2023-04 / 82444370069
80133 - IVD - Notificação de produto Classe II / 0921186231
Kit de teste de Hormônio Folículo-Estimulante (FSH) (ouro coloidal)
25351.571925/2023-86 / 82444370070
80133 - IVD - Notificação de produto Classe II / 0926659235

GOLDNER & CO. INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 43.007.378/0001-20
G500+ Liga Co-Cr
25351.609183/2023-79 / 82309629006
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0986150231

HANESBRANDS BRASIL TÊXTIL LTDA / 00.626.948/0001-57
Meia Elástica de Compressão para Uso Medicinal - Hanes Support
25351.610046/2023-87 / 80017170021
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0987324233
Meia Elástica de Compressão para Uso Medicinal - Hanes Support
25351.613269/2023-04 / 80017170022
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0992482232
Meia Elástica de Compressão para Uso Medicinal - Hanes Support
25351.613793/2023-77 / 80017170023
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0993057233
Meia Elástica de Compressão para Uso Medicinal - Hanes Support
25351.609723/2023-14 / 80017170020
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0986978230

INTÉRSURGICAL COMÉRCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA / 46.892.210/0001-32
Ircuito Respiratório Antimicrobiano Silver Knight
25351.623361/2023-74 / 82737659053
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1008564231
Circuito Respiratório Flextube
25351.623360/2023-20 / 82737659052
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1008563234
Máscara para anestesia aromatizada
25351.612735/2023-26 / 82737659049
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0991699238
Filtro HMEF com cateter mount estéril
25351.612736/2023-71 / 82737659050
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0991700236
Máscara facial Intersurgical
25351.623359/2023-03 / 82737659051
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1008562238

IVOCLEAR VIVADENT LTDA. / 04.004.675/0001-60
PressCeramic
25351.613629/2023-60 / 80091449020
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0992885230

JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. / 00.489.050/0001-84
GUIA DE BROCA TREFINA PARA KIT RESGATE HS E GM
25351.624343/2023-18 / 10344429045
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1010400231
REMOVEDOR DE ROSCA FRATURADA HS
25351.625062/2023-74 / 10344429046
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1011195232

JOSE FERNANDES FRANCO CAMARGO / 39.272.994/0001-30
CARTUCHOS COM AGULHAS DESCARTÁVEIS QUATAT
25351.617527/2023-13 / 82709069001
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 0999060236

LABOR IMPORT COMÉRCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 01.005.728/0001-79
AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
25351.624713/2023-17 / 10369469051
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1010811231

LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA / 63.067.904/0001-54
Ion Torrent Dx FPPE Sample Preparation Kit
25351.501866/2023-89 / 10358940135
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0810705231

Loccus do Brasil LTDA / 05.094.718/0002-99
Extracta® Kit - DNA e RNA de Patógenos MDx
25351.568496/2023-60 / 82472170023
80197 - IVD - Notificação de produto Classe I / 0921058233

LONGEVICORP S.A / 31.746.037/0001-97
Urine Collector
25351.613303/2023-32 / 82530260002
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0992519233

MÁRCINICHEN FARMACEÚTICA LTDA / 02.310.701/0002-33
Manta protetora para criolipólise tradicional - Technature
25351.613239/2023-90 / 82741810001
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0992443237

MAX DIAGNOSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME / 07.776.581/0001-05
ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA MAX S-3
25351.575177/2023-19 / 81452980014
80133 - IVD - Notificação de produto Classe II / 0932223231
ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA MAX S-5
25351.575172/2023-88 / 81452980013
80133 - IVD - Notificação de produto Classe II / 0932217231

MED FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 43.396.342/0001-85
Kit para aspiração MEDFLEX

Processo nº 288/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Sumário

Atos do Poder Judiciário..... 1
Presidência da República..... 2
Ministério da Agricultura e Pecuária..... 4
Ministério das Cidades..... 4
Ministério das Comunicações..... 10
Ministério da Cultura..... 18
Ministério da Defesa..... 24
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar..... 24
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome..... 24
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços..... 25
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania..... 26
Ministério da Educação..... 26
Ministério do Esporte..... 33
Ministério da Fazenda..... 34
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos..... 40
Ministério da Igualdade Racial..... 42
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional..... 42
Ministério da Justiça e Segurança Pública..... 45
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima..... 65
Ministério de Minas e Energia..... 65
Ministério das Mulheres..... 72
Ministério da Pesca e Aquicultura..... 73
Ministério do Planejamento e Orçamento..... 150
Ministério de Portos e Aeroportos..... 152
Ministério dos Povos Indígenas..... 153
Ministério da Previdência Social..... 154
Ministério da Saúde..... 154
Ministério do Trabalho e Emprego..... 241
Ministério dos Transportes..... 241
Controladoria-Geral da União..... 242
Ministério Público da União..... 242
Tribunal de Contas da União..... 248
Defensoria Pública da União..... 259
Poder Legislativo..... 261
Poder Judiciário..... 261
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais..... 262

Esta edição é composta de 265 páginas

Atos do Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PLENÁRIO

DECISÕES

Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade (Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)

Julgamentos

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.521 (1)
ORIGEM : ADI - 109777 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB
ADV.(A/S) : GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS (8587/DF)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação para julgar improcedente o pedido e declarar a constitucionalidade do art. 71, I e II, da Lei Complementar n. 28, de 14 de janeiro de 2000, do Estado de Pernambuco, e não conheceu da ação quanto ao art. 33, IV e § 4º, da Lei n. 7.551, de 27 de dezembro de 1977, na redação dada pela Lei n. 11.630, de 28 de janeiro de 1999, ambas do Estado de Pernambuco, porquanto em causa dispositivos expressamente revogados pela Lei Complementar pernambucana n. 28, de 14 de janeiro de 2000. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023.

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.056 (2)
ORIGEM : ADI - 152037 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES

REATOR DO ACÓRDÃO : MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTDO.(A/S) : APESP - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : SINDIPROESP - SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADV.(A/S) : FLAVIO LUIZ YARSHHELL (A1481/AM, 67174/BA, 02050/AD/DF, 34173/ES, 60972/GO, 205759/MG, 205759/MG, 26006-A/MS, 28937/A/MT, 31687-A/PA, 55140/PE, 69022/PR, 181770/RJ, 121288A/RS, 61264/SC, 88098/SP)
INTDO.(A/S) : ANAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO

ADV.(A/S) : ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS (6190A/AL, 18907/DF, 18907-A/PB, 01560/PE, 266812/SP)
ADV.(A/S) : ANGELO LONGO FERRARO (37922/DF, 261268/SP)
INTDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PÚBLICA - IBAP
ADV.(A/S) : CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO (98071/SP)

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 87 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator) e Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: "Não ofende a Constituição Federal a previsão, em ato normativo estadual, de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira". Redigirá o acórdão o Ministro Roberto Barroso. Falou, pela interposição ANAPE - Associação Nacional dos Procuradores de Estado, o Dr. Miguel Filipi Pimentel Novaes. Plenário, Sessão Virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023.

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.899 (3)
ORIGEM : ADI - 85649 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
INTDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação e julgou procedente o pedido nela formulado, para declarar inconstitucional, in totum, a Lei distrital n. 3.923, de 19 de dezembro de 2006, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023.

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.614 (4)
ORIGEM : ADI - 5614 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) E OUTRO(A/S)

Decisão: Após o voto da Ministra Rosa Weber (Presidente e Relatora), que conhecia da ação direta e julgava procedente o pedido, para declarar a Inconstitucionalidade das gratificações de (i) Membro do Colégio de Procuradores de Justiça - Secretário, (ii) Membro do Conselho Superior do Ministério Público - Secretário, (iii) Membro do Conselho Superior do Ministério Público, (iv) Coordenador de Centro de Apoio Operacional e (v) Coordenador de Procuradorias ou Promotorias, previstas no Anexo Único da Lei nº 7.736/2013 do Estado do Pará, e, ainda, modulava os efeitos da decisão, para afastar a obrigação de restituir os valores recebidos de boa-fé com base na norma inconstitucional até a publicação da ata de julgamento, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023.

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.944 (5)
ORIGEM : 5944 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : CEARÁ
RELATOR : MIN. ANDRÉ MENDONÇA

REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS - ANADFP
ADV.(A/S) : ILTON NORBERTO ROBL FILHO (38677/DF, 43824/PR, 48138-A/SC)
ADV.(A/S) : ISABELA MARRAFON (0008565/MT)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARA
ADV.(A/S) : ARAO JOSE GABRIEL NETO (44315/DF)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, julgou-a improcedente, nos termos do voto do Relator. Falou, pela requerente, o Dr. Ilton Norberto Robl Filho. Plenário, Sessão Virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023.

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.653 (6)
ORIGEM : 6653 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES

REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
ADV.(A/S) : MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO (15662/PB) E OUTRO(A/S)

Decisão: Após os votos dos Ministros Nunes Marques (Relator), André Mendonça e Alexandre de Moraes, que julgavam procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos trechos "importando em crime de responsabilidade a ausência injustificada" e "autoridades públicas estaduais de qualquer nível, importando crime de responsabilidade, com pena de destituição de função, a recusa ou não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas" dispostos, respectivamente, no caput e no § 2º do art. 53 da Constituição do Estado da Paraíba, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023.

Foram publicadas em 29/9/2023 as edições extras nºs 187-A, 187-B e 187-C do DOU. Para acessar o conteúdo, clique nos nºs das edições.


AVISO



SINNOWA

HEALTHCARE 

Nota n° 290
Processo n° 0282024
Data:

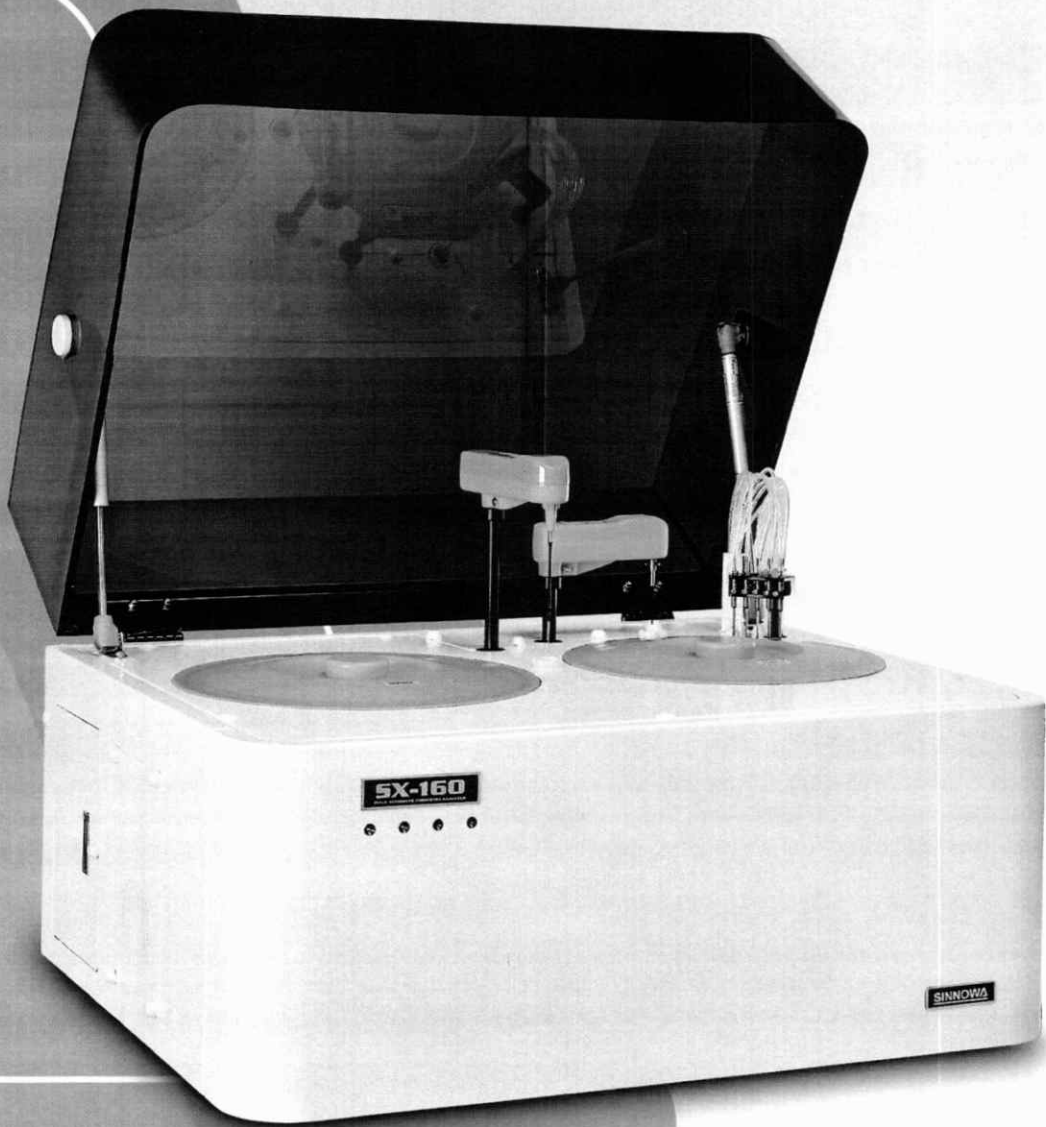

SX-160

ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente Automático



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SX-160 ANALISADOR BIOQUÍMICO

Nota nº 295
Processo nº 028/2024
Rubrica:



CARACTERÍSTICAS SINNOWA	TECNOLOGIA SINNOWA	BENEFÍCIOS
Velocidade	200 testes por hora - fotométricos/ colorimétricos/turbidimétricos. +150 ISE potenciometria por hora (opcional)	Novo software: maior velocidade com precisão. Acesso randômico. Totalmente automatizado.
Reagentes	Até 72 posições para reagentes - Mono e Bi reagentes sistema twin. Refrigerados entre 2 a 12°C - 24H.	Possibilidade de uso de qualquer marca de reagentes definida pelo usuário (sistema totalmente aberto). Com interruptor separado, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa.
Reagentes Consumo	Leitura a partir de 100 µL por teste.	Consumo reduzido.
Calibradores e Controles	Posições e quantidades livres para: Calibração linear/não linear/um ponto/ multiponto e fator	Cobertura de todas as técnicas.
Cubetas de Reação	60 cubetas autolaváveis individuais.	Com sistema automático que lava e seca as cubetas de incubação para reação.
Amostras	50 posições simultâneas para pacientes, calibradores, controles e outras soluções.	Carregamento contínuo das amostras. Tubo primário de 7mm a 15mm ou micro tubos.
Amostras Urgência	Prioriza Urgências (STAT). Em qualquer posição de amostra.	Libera o resultado assim que terminado o teste e, posteriormente, retoma a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática.
Código de Barras	Leitor de código de barras embutido internamente, acoplado ao rotor de amostras/reagentes.	Permitindo ao operador adicionar amostras em ordem aleatória. Pronto para interfacear com o software operacional do laboratório.
Estação de Lavagem	Lavagem automática das cubetas de reação em 5 canais.	Lava e seca automaticamente após cada teste, continuamente com baixo consumo de água.
Braços e Agulhas	1 para reagente/amostra, com lavador interno e externo. 1 mixer homogeneizador independente.	Agulhas lavadas automaticamente com água em alta pressão, livre de contaminações. Arraste menor que 0,05%. Programa para lavagens extras (água e ou detergente) entre as amostras de técnicas contaminantes cruzadas.
Sistema Operacional	Sistema Windows™ XP - 7 - 8 ou 10 em português.	Moderno, amigável e intuitivo.
Diluições Automáticas	Pré-diluições até: 1:500 e Pós-diluições até 1:300, para resultados acima da linearidade.	Automação total das amostras, reagentes, calibradores e controles.
Memória	Armazena em computador externo por memória SSD (Flash) com opção de transferência para qualquer tipo de mídia externa: Pen drive, CD, SSD, etc.	Mais de 1 milhão de Resultados de exames realizados e C.Q. Mais de 200 Programações de Reagentes simultaneamente. Possibilidade de uso de qualquer marca de reagente definida pelo usuário.
C.Q. Controle Qualidade	6 controles de qualidade por item incluindo Gráficos de Levey Jennings, Gráficos X-R e Regras Múltiplas de Westgard.	Opção de comparação por plotagem gêmea (twin plot) comparativa de 2 controles e banco de dados acumulados. Completo e auto armazenável.
Interfaceamento	Comunicação bidirecional. RS-232 - LAN Ethernet e USB	Os mais difundidos do mercado.
Manutenções	Sistema de manutenção programada em software.	Alerta automático por ciclos ou por tempo. Adaptável ao perfil do usuário.

CAPACIDADES


SOFTWARE



Edição nº 2938/2024
Processo nº 16366/2023

	CARACTERÍSTICAS SINNOWA	TECNOLOGIA SINNOWA	BENEFÍCIOS
SISTEMA FOTOMÉTRICO	Filtros	Capacidade de até 12 Filtros, 10 por padrão + 2 opcionais. Comprimentos de onda com range de 340nm a 800nm, com intervalos a escolher.	Cobertura para qualquer tipo de exame. Sistema de Prisma - Grade de refração.
	Fonte de Luz	Lâmpada de Halogênio/Tungstênio. Transmitida por fibra óptica. Grade de refração reversa.	Sistema stand by. Economia de energia e longa duração.
	Precisão dos Filtros	± 2 nm.	Resultados precisos.
PIPETAGEM	Seringa de Pipetagem	Seringa sistema Ultra Cerâmica aspiração a partir de 1µL Volume de aspiração de reagente entre 1 e 500µL com precisão de 0,5µL. Volume de amostra entre 1µL a 100µL, com precisão de 0,1µL.	Embolo de alta resistência. Durabilidade e precisão inigualáveis.
	Métodos	Absorbância, ponto final (com e sem branco de amostra/reagente); Cinética (logit-log 4p, logit-log 5p); Dois pontos; Multi padrão; Bi cromático; Cálculo com fator; Curva de calibração linear e não linear ou Padrão; Solução de soro neutra; Spline; Exponencial; Polinomial; Parábola; Imunoturbidimétrico e Potenciometria (ISE opcional).	Cobre todas as técnicas de: Bioquímica; Turbidimetria e Potenciometria (ISE Opcional).
SISTEMA DE LEITURA	Escala de Medição	-0,1 até 4.000 O.D - ABS.	Acurácia e reprodutibilidade de resultados.
	Linearidade Fotométrica	± 2%.	
	Exatidão Fotométrica	± 1%.	
	Desvio	≤ 1%.	
SENSORES E ALERTAS	Incubação	Sistema controlado de 25°C a 40°C. Precisão de ± 0,1°C.	Gerenciamento automático do inventário de reagentes. Evita erros por falta de reagentes e amostras. Com retração, evita a quebra de agulha. Evita parada da rotina por falta de água ou esgoto cheio.
	Sensor de Agulhas	Sensores com alerta sonoro e aviso em tela para Volume de Reagentes e Amostras.	
	Sensor de Braços	Sensor anti-impacto, vertical e horizontal.	
	Sensor de Reservatórios	Sensor com alerta sonoro e aviso em tela para reservatórios de água e esgoto.	

DIMENSÕES

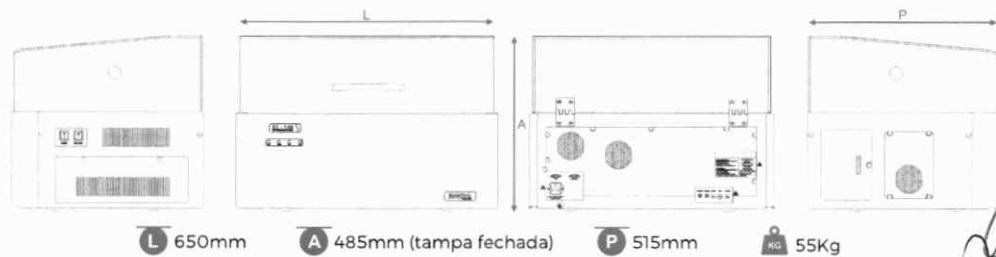

ALIMENTAÇÃO 100 a 240V

Bivolt automático.

REGISTRO




Registro: 81452980003

SX-160

ANALISADOR BIOQUÍMICO


Totalmente Automático

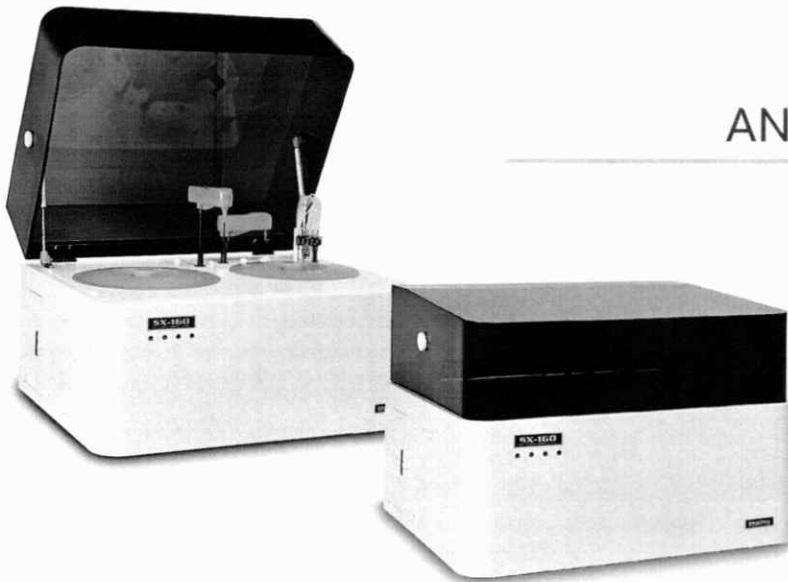


NOVO SOFTWARE



COM VELOCIDADE
OTIMIZADA

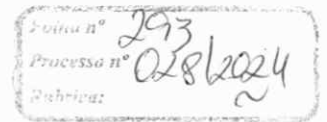

2 BRAÇOS - 1 AGULHA E
1 MIXER INDEPENDENTES



50 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS
SIMULTÂNEAS (MICROTUBOS
OU TUBOS PRIMÁRIOS)



60 CUBETAS SIMULTÂNEAS
AUTOLAVÁVEIS



72 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS
PARA REAGENTES - MONO OU BI




LEITOR CÓDIGO DE BARRAS
ACOPLADO AO CARROSSEL DE
AMOSTRAS / REAGENTES




LAVADOR / SECADOR
AUTOMÁTICO DE
CUBETAS 5 CANAIS



RÁPIDO / PRÁTICO
COMPACTO / COMPLETO



CHAVES LIGA / DESLIGA
SEPARADAS PARA
REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTO



SERINGA ULTRA-CERÂMICA

SINNOWA
HEALTHCARE

R. José C Teixeira, 546 - Recanto das Flores - Ribeirão Preto - SP, 14110-000

Vendas: 16 3636 4433 | vendas@sinnowabrazil.com.br

www.sinnowabrazil.com.br

Nota n° 294
Processo n° 028/2024
assinatura

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME

CNPJ 07.776.581/0001-05

Autorização

8.14.529-8

Produto Analisador Bioquímico Automático Sinnowa

Modelo Produto Médico

SX-140

SX-160

SX-260

SX-300

SX-400

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas

Registro 81452980003

Processo 25351.047554/2018-59

Fabricante Legal

- FABRICANTE: SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Processo nº 295
Rubrica: 028/2024

ISSN 1677-7042



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Suplemento ao Nº 48

Brasília - DF, segunda-feira, 12 de março de 2018



SEÇÃO

1

Sumário

PÁGINA

Ministério da Saúde 1

Ministério da Saúde

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANTITÁRIA

DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO
E REGISTRO SANITÁRIOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 544, DE 8 DE MARÇO DE 2018

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 91, II aliado ao art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo 1 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 209, de 17 de janeiro de 2018, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

ANEXO

NOME DA EMPRESA: 3M DO BRASIL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00378-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: 3M DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.529214/2013-32
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0378.0111.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027290/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: 3M DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.529214/2013-32
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0378.0111.003-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLUCIDA + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027290/18-6

NOME DA EMPRESA: ACLIVE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01924-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: ACLIVE DRX
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.007380/2003-13
NÚMERO DE REGISTRO: 3.1924.0062.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BALDE PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3201015 DETERGENTES DE USO PROFISSIONAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2045246/17-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAVCLEAN
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.200089/2002-23
NÚMERO DE REGISTRO: 3.1924.0060.001-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1350748/17-6

NOME DA EMPRESA: AEROFLEX INDÚSTRIA DE AERÓSOL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.07155-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: BUZZ OFF EXTREME MULTI INSETICIDA
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.347089/2017-54
NÚMERO DE REGISTRO: 3.7155.0002.001-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: LATA AEROSSOL
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3769 Reconsideração de Indeferimento
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0062200/18-7

NOME DA EMPRESA: ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00388-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: NORCLOR DC 60
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.065951/2008-31
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0388.0030.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLÁSTICO + BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3211051 DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2017159/17-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: FLEXUS CH TABLETE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.090818/2008-12
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0388.0029.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: BALDE PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2017156/17-1

NOME DA EMPRESA: ATUANTE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-ME
AUTORIZAÇÃO: 3.06154-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: ATUANTE SUPRA
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.631148/2017-98
NÚMERO DE REGISTRO: 3.6154.0001.001-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: GALAO PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300213 DETERGENTE PARA USO ESPECÍFICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneros
NOME DO PRODUTO E MARCA: ATUANTE SUPRA
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.631148/2017-98
NÚMERO DE REGISTRO: 3.6154.0001.002-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300213 DETERGENTE PARA USO ESPECÍFICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneros

NOME DA EMPRESA: AUTOLIMPE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
AUTORIZAÇÃO: 3.05321-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESENGRAXANTE ALCALINO DX 10.000
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.549708/2017-61
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5321.0003.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: GALAO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneros
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESENGRAXANTE ALCALINO DX 10.000
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.549708/2017-61
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5321.0003.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneros
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESENGRAXANTE ALCALINO DX 10.000
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.549708/2017-61
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5321.0003.003-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: TAMBOR METALICO + SACO PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneros

NOME DA EMPRESA: BASF S/A
AUTORIZAÇÃO: 3.00404-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: PLURESTO PRO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.719428/2012-97
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0404.0049.001-9
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2023

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012018031200001

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Folha nº 296
Processo nº 028/2024
Subprocesso



IgG Anti-SSA 60KD
FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
CLASSE : II 80915630028
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) 25351.029777/2018-34
VCA IgG
FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
96 Testes: Microplaca - 1 microplaca, Curva de Calibração - 1 frasco x 4 ml CAL1, 1 frasco x 4 ml CAL2, 1 frasco x 2 ml CAL3, 1 frasco x 2 ml CAL4, 1 frasco x 2 ml CAL5, 1 frasco x 4 ml CAL6, Soro Controle - 1 frasco Liofilizado, Tampão de Lavagem Concentrado - 2 frascos x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 16ml, Cromógeno/Substrato - 1 frasco x 16ml, Acido Sulfúrico - 1 frasco x 15ml
CLASSE : II 80915630029
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.029944/2018-24
IgG Anti-SSA 52KD
FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
CLASSE : II 80915630030
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) 25351.029998/2018-11
FORESIGHT LH EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
480 Testes: Placa de micropoços LH - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado LH - 5 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, LH Calibrador 1 - 5 x 2mL, LH Calibrador 2 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 3 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 4 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 5 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 6 - 5 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 10
96 Testes: Placa de micropoços LH - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado LH - 1 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40mL, Substrato A - 1 x 8mL, Substrato B - 1 x 8mL, Solução Stop - 1 x 8mL, LH Calibrador 1 - 1 x 2mL, LH Calibrador 2 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 3 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 4 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 5 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 6 - 1 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 2
CLASSE : II 80915630031
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) TOTAL 25351.030005/2018-45
FORESIGHT hCG EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
480 Testes: Placa de micropoços hCG - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado hCG - 5 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, hCG Calibrador 1 - 5 x 12mL, hCG Calibrador 2 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 3 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 4 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 5 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 6 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 7 - 5 x 0,5mL, Filmes para selagem das placas - 10
96 Testes: Placa de micropoços hCG - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado hCG - 1 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40mL, Substrato A - 1 x 8mL, Substrato B - 1 x 8mL, Solução Stop - 1 x 8mL, hCG Calibrador 1 - 1 x 12mL, hCG Calibrador 2 - 1 x 0,5mL, hCG Calibrador 3 - 1 x 0,5mL, hCG Calibrador 4 - 1 x 0,5mL, hCG Calibrador 5 - 1 x 0,5mL, hCG Calibrador 6 - 1 x 0,5mL, hCG Calibrador 7 - 1 x 0,5mL, Filmes para selagem das placas - 2
CLASSE : II 80915630032
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados PROLACTINA 25351.030007/2018-34
FORESIGHT PRL EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
480 Testes: Placa de micropoços PRL - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado PRL - 5 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, PRL Calibrador 1 - 5 x 2mL, PRL Calibrador 2 - 5 x 1,0mL, PRL Calibrador 3 - 5 x 1,0mL, PRL Calibrador 4 - 5 x 1,0mL, PRL Calibrador 5 - 5 x 1,0mL, PRL Calibrador 6 - 5 x 1,0mL, PRL Calibrador 7 - 5 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 10
96 Testes: Placa de micropoços PRL - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado PRL - 1 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40mL, Substrato A - 1 x 8mL, Substrato B - 1 x 8mL, Solução Stop - 1 x 8mL, PRL Calibrador 1 - 1 x 2mL, PRL Calibrador 2 - 1 x 1,0mL, PRL Calibrador 3 - 1 x 1,0mL, PRL Calibrador 4 - 1 x 1,0mL, PRL Calibrador 5 - 1 x 1,0mL, PRL Calibrador 6 - 1 x 1,0mL, PRL Calibrador 7 - 1 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 2

CLASSE : II 80915630033
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) 25351.030022/2018-82
FORESIGHT FSH EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
480 Testes: Placa de micropoços FSH - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado FSH - 5 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, FSH Calibrador 1 - 5 x 2mL, FSH Calibrador 2 - 5 x 1,0mL, FSH Calibrador 3 - 5 x 1,0mL, FSH Calibrador 4 - 5 x 1,0mL, FSH Calibrador 5 - 5 x 1,0mL, FSH Calibrador 6 - 5 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 10
96 Testes: Placa de micropoços FSH - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado FSH - 1 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40mL, Substrato A - 1 x 8mL, Substrato B - 1 x 8mL, Solução Stop - 1 x 8mL, FSH Calibrador 1 - 1 x 2mL, FSH Calibrador 2 - 1 x 1,0mL, FSH Calibrador 3 - 1 x 1,0mL, FSH Calibrador 4 - 1 x 1,0mL, FSH Calibrador 5 - 1 x 1,0mL, FSH Calibrador 6 - 1 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 2
CLASSE : II 80915630034
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados Instrumento para preparo e processamento de amostras - fase pré-analítica 25351.030027/2018-13
LAVADORA PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS
FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD - INDIA
WASHWELL PLATE
CLASSE : II 80915630035
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados Instrumento para preparo e processamento de amostras - fase pré-analítica 25351.030029/2018-02
LISA SHAKE
FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD - INDIA
Lisa Shake
CLASSE : II 80915630036
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.032792/2018-60
IgG Anti-Centromere B
FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
CLASSE : II 80915630037
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
HB LABOR COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 8 05081-8
PROTEINA C REATIVA 25351.037275/2015-81
PCR TURBI - Proteína C Reativa - Turbidimétrico
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
1 x 50 mL
CLASSE : II 80508180001
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
Fotometro 25351.122138/2015-72
Analisador Bioquímico Semi Automático Sinnova
FABRICANTE : SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
SX-3000M
SX-3100
CLASSE : I 80508180002
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
Instrumento para análise de urina 25351.122150/2015-93
Analisador Bioquímico Automático Sinnova
FABRICANTE : SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
SX-140
SX-160
SX-260
SX-300
SX-400
CLASSE : I 80508180004
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
ALFA 1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA (AGPA) 25351.765333/2014-46
Alfaglico Turbi - Alfa-1-Glicoproteína Ácida - Turbidimétrica Linear
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
3915010 - frasco 1x50 ml
CLASSE : II 80508180009
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.769436/2014-37
i-FOB Calibrador
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
1 x 2 mL
CLASSE : III 80508180010
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
ALBUMINA 25351.765290/2014-65
Microalbuminúria Turbidimétrico - Linear
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA

Calibrador Turbidimétrico 1x 1 mL; Diluente (RI) : 1x 40 mL, Latex (R2) : 1x10 mL
CLASSE : II 80508180011
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.769519/2014-95
i-FOB CONTROLE
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
2x2 mL
CLASSE : III 80508180012
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.769526/2014-20
i-FOB Turbidimétrico
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
i-FOB Turbidimétrico 1x50 ml
i-FOB Turbidimétrico 2x50 ml
CLASSE : III 80508180013
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
FATOR REUMATOIDE 25351.765351/2014-21
FR TURBI - FATOR REUMATOIDE
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
313002 (1 x 50 mL) R1.Reagent 1 x 40 mL, R2.Reagent 1 x 10 mL, CAL 1 X 2 mL
313002 (2 x 50 mL) R1.Reagent 2 x 40 mL, R2.Reagent 2 x 10 mL, CAL 1 X 2 mL
313002 (2 x 200 mL) R1.Reagent 2 x 160 mL, R2.Reagent 4 x 20 mL, CAL 1 X 2 mL
CLASSE : II 80508180015
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PROTEINA C REATIVA 25351.765287/2014-37
PCR Ultra Sensível TURBI
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
PCR US - Latex 1x10mL
PCR-US Diluente 1x40mL
PCR-US-Calibrador Turbidimétrico 1x2mL
CLASSE : II 80508180016
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
ANTIESTREPTOLISINA 25351.765331/2014-98
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
3110030 (2x 50mL) - R1: 2x40 mL
3110030 (2x 50mL) - R2: 2x10 mL
3110030 (2x 50mL) - CAL: 1x1 mL
3110035 (2 x 200mL) - CAL: 1x1 mL
3110035 (2 x 200mL) - R1: 2x160 mL
3110035 (2 x 200mL) - R2: 4x20 mL
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - CAL: 1x1 mL
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R1: 1x40 mL
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R2: 1x10 mL
CLASSE : II 80508180017
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME 8.14529-8
PROTEINA C REATIVA 25351.047605/2018-42
PCR TURBI - Proteína C Reativa - Turbidimétrico
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
1 x 50 mL
CLASSE : II 81452980000
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.047670/2018-78
i-FOB CONTROLE
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
2x2 mL
CLASSE : III 81452980001
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.047553/2018-12
i-FOB Calibrador
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
1 x 2 mL
CLASSE : III 81452980002
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados Instrumento para análise de urina 25351.047554/2018-59
Analisador Bioquímico Automático Sinnova
FABRICANTE : SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
SX-140
SX-160
SX-260
SX-300
SX-400
CLASSE : II 81452980003
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados ALFA 1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA (AGPA) 25351.047769/2018-70
Alfaglico Turbi - Alfa-1-Glicoproteína Ácida - Turbidimétrica - Linear
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA
3915010 - frasco 1x50 ml
CLASSE : II 81452980004
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados ANTIESTREPTOLISINA 25351.047813/2018-41
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L - ESPANHA



Processo nº 028/2018

3110030 (2x 50mL) - R1: 2x40 mL
 3110030 (2x 50mL) - R2: 2x10 mL
 3110030 (2x 50mL) - CAL: 1x1 mL
 3110035 (2 x 200mL) - CAL: 1x1 mL
 3110035 (2 x 200mL) - R1: 2x160 mL
 3110035 (2 x 200mL) - R2: 4x20 mL
 ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - CAL: 1x1 mL
 ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R1: 1x40 mL
 ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R2: 1x10 mL
 CLASSE - II 81452980005
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 PROTEÍNA C REATIVA 25351.047847/2018-90
 PCR Ultra Sensível TURBI
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 PCR US - Latex 1x10mL
 PCR-US Diluente: 1x40mL
 PCR-US-Calibrador Turbidimétrico 1x2mL
 CLASSE - II 81452980006
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 FATOR REUMATOÍDE 25351.047847/2018-36
 FR TURBI - FATOR REUMATOÍDE
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 313002 (1 x 50 mL): R1.Reagent 1 x 40 mL; R2.Reagent 1 x 10 mL; CAL 1 X 2 mL
 313002 (2 x 50 mL): R1.Reagent 2 x 40 mL; R2.Reagent 2 x 10 mL; CAL 1 X 2 mL
 313002 (2 x 200 mL): R1.Reagent 2 x 160 mL; R2.Reagent 4 x 20 mL; CAL 1 X 2 mL
 CLASSE - II 81452980007
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 SANGUE OCULO EM FEZES 25351.047558/2018-37
 i-FOB Turbidimétrico
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 i-FOB Turbidimetric 1x50 ml
 i-FOB Turbidimetric 2x50ml
 CLASSE III 81452980008
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 Fotometro 25351.048034/2018-63
 Analisador Bioquímico Semi Automático Sinnova
 FABRICANTE : SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
 SX-3000M
 SX-3100
 CLASSE : I 81452980009
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 ALBUMINA 25351.048017/2018-26
 Microalbuminúria Turbidimétrico - Linear
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 Calibrador Turbidimétrico: 1x 1 mL; Diluente (R1) :1x 40 mL; Latex (R2) :1x10 mL
 CLASSE - II 81452980010
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 RZ DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA EPP 8.03130-4
 Instrumento destinado a imunoenaios 25351.525855/2008-55
 LEITURA DE MICROPLACA
 FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD. - INDIA
 READWELL PLATE, READWELL STRIP
 CLASSE - II 80313040039
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas 25351.307575/2010-61
 FOUR CLOT COAGULOMETRO
 FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD. - INDIA
 CLASSE - II 80313040086
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 HORMÔNIO ESTIMULANTE DE TIREÓIDE (TSH) 25351.307635/2010-05
 DS EIA TSH
 FABRICANTE : RPC DIAGNOSTIC SYSTEMS - RÚSSIA (FEDERAÇÃO RUSSA)
 Kit para 96 testes
 CLASSE - II 80313040087
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Centrífuga 25351.289293/2013-50
 CENTRÍFUGA POWER SPIN
 FABRICANTE : United Products & Instruments, Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 Série FX, modelo C806;
 Série FX, modelo C808
 Série LX, modelo C856
 Série LX, modelo C858
 Série MX, modelo C8624
 CLASSE - I 80313040088
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Instrumento para análise de urina 25351.279681/2015-54
 DRG. HYBRID XL
 FABRICANTE : DRG INSTRUMENTS GMBH - ALEMANHA
 CLASSE - I 80313040092
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade

Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas 25351.428049/2015-51
 easyCLOT
 FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD. - INDIA
 CLASSE - II 80313040093
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) 25351.010305/2016-40
 VCA IgM
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 Microplaca - 1 microplaca, Curva de Calibração - 1 frasco x 4 ml CAL1, 1 frasco x 4 ml CAL2, 1 frasco x 2 ml CAL3, 1 frasco x 2 ml CAL4, 1 frasco x 4 ml CAL5, Soro Controle - 1 frasco liofilizado, Tampão de Lavagem Concentrado - 1 frascos x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 0,8ml, Diluente do Antígeno - 1 frasco x 16 ml, Antígeno EBV VCA - 6 frascos liofilizados, Diluente da Amostra - 2 frascos x 60ml, Cromógeno/Substrato - 1 frasco x 16ml, Acido sulfúrico - 1 frasco x 15ml
 CLASSE - II 80313040095
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTI-ANTÍGENOS NUCLEARES EXTRAÍVEIS (ENA) 25351.010695/2016-30
 ENA 6 Parameters Profile
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 12 testes: Microplaca - 12 x 8 poços, Controle Negativo - 1 frasco x 2ml, Controle Positivo - 1 frasco x 2,0ml, Solução de Lavagem conc. - 1 frasco x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 16ml, Cromógeno/Substrato - 1 frasco x 16ml, Acido sulfúrico - 1 frasco x 15ml, Diluente Amostras - 2 frascos x 60ml
 CLASSE - II 80313040096
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104985/2016-33
 IgG Anti U1-snRNP 68
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040097
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105004/2016-86
 IgG Anti-Centromere B
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040098
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104907/2016-47
 IgG Anti-Sm
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes: 1 microplaca 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0,12,5, 25,50,100; 200 arU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040099
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104950/2016-42
 IgG anti-dsDNA
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 U/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040100
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104935/2016-44
 ANA 8 PARAMETER PROFILE
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 12 testes - Microplaca -1 microplaca - 6 tiras x 8 poços, Controle Negativo 1x2ml, Controle Positivo 1 x2ml, Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040101
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade

ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105038/2016-48
 IgG Anti-Jo-1
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040102
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105057/2016-52
 ANA SCREENING IgG
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - Microplaca -1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Controle Negativo 1x2ml, Controle Positivo 1 x2ml, Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040103
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105087/2016-14
 IgG Anti-SSA 60KD
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040104
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) 25351.536461/2016-05
 VCA IgG
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 Testes: Microplaca - 1 microplaca, Curva de Calibração - 1 frasco x 4 ml CAL1, 1 frasco x 4 ml CAL2, 1 frasco x 2 ml CAL3, 1 frasco x 2 ml CAL4, 1 frasco x 2 ml CAL 5, 1 frasco x 4 ml CAL 6, Soro Controle - 1 frasco liofilizado, Tampão de Lavagem Concentrado - 2 frascos x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 16ml, Cromógeno/Substrato - 1 frasco x 16ml, Acido Sulfúrico - 1 frasco x 15ml
 CLASSE - II 80313040105
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104965/2016-06
 IgG Anti-SSA 52KD
 FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE - II 80313040106
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) 25351.259802/2017-01
 FORESIGHT LH EIA TEST KIT
 FABRICANTE : ACORN BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
 480 Testes: Placa de micropoços LH - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado LH - 5 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, LH Calibrador 1 - 5 x 2mL, LH Calibrador 2 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 3 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 4 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 5 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 6 - 5 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 10
 96 Testes: Placa de micropoços LH - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado LH - 1 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40mL, Substrato A - 1 x 8mL, Substrato B - 1 x 8mL, Solução Stop - 1 x 8mL, LH Calibrador 1 - 1 x 2mL, LH Calibrador 2 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 3 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 4 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 5 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 6 - 1 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 2
 CLASSE - II 80313040107
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) TOTAL 25351.259797/2017-91
 FORESIGHT HCG EIA TEST KIT
 FABRICANTE : ACORN BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
 480 Testes: Placa de micropoços hCG - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado hCG - 5 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, hCG Calibrador 1 - 5 x 12mL, hCG Calibrador 2 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 3 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 4 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 5 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 6 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 7 - 5 x 0,5mL, Filmes para selagem das placas - 10

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Conta n° 298
Processo n° 028/2024
Tribunal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

CERTIFICADO DE PRODUTO

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, CERTIFICA que o produto abaixo indicado, é fabricado de acordo com as leis vigentes no Brasil, com a sua venda autorizada em todo o Território Brasileiro.

RAZAO SOCIAL: MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS

CNPJ: 07.776.581/0001-05

ENDEREÇO: Rua José da Costa Teixeira, 546 CEP: 14110-000

NOME TÉCNICO	Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou
NOME COMERCIAL	Analisador Bioquímico Automático Sinnowa
CLASSE DE RISCO	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
LOCAL DE FABRICAÇÃO	SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - Fabricante Legal
REGISTRO Nº	81452980003
DATA DO REGISTRO	12/03/2018
VÁLIDO ATÉ	VIGENTE

MODELO COMERCIAL:

SX-300, SX-260, SX-400, SX-140, SX-160

Documento emitido eletronicamente às: 18:04:52 do dia 31/08/2018 (Hora e data de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: 9198.3AA9.3F15.0008.5721.7D53.72AA.D4BA.CB1B.67B3

Conforme §2º, Art. 6º, RDC nº 27 de 15 de maio de 2013, qualquer alteração ou inclusão pós-registro ou pós-cadastro deferida que altere as informações do documento emitido, torná-lo-á inválido.

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: <http://www.anvisa.gov.br/validacertificadogtgs>



Folha n° 299
Processo n° 0286024
Rubrica:

ENVELOPE N° 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2024 - PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
DATA: 21.06.24
HORA: 08h30min
MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA

MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA

CNPJ: 34.224.073/0001-89 Insc. Est.: 126522332

End.: Rua Espírito Santo, n.º 20, Bairro: Maranhão Novo, CEP: 65.903-100 Fone: (99) 3073-2687

mpmedicamentos3@gmail.com Imperatriz - MA

E-mail:

Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carolina
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2024-PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2024-PMC

CARTA-PROPOSTA

1. A empresa **MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.224.073/0001-89, com sede à Rua: Espírito Santo, 20, bairro: Maranhão Novo, na cidade de Imperatriz-MA, CEP: 65.903-100, representada por seu sócio administrador o **Sr. MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA**, CI nº 95886098-0, CPF nº 641.791.333-34, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2024-PMC**, especialmente a Lei nº 14.133/2021, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

2. Propomos o valor total de **R\$ 149.289,31 (Cento e quarenta e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos)**, para o Registro de Preços para fornecimento de **“Aquisição de Equipamentos Laboratoriais”**, objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à **Prefeitura Municipal de Carolina**, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2024-PMC**, obedecendo as especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

- a) cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

3. O prazo de validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias consecutivos** a contar da data da sua entrega.

4. Comprometemos a entregar os **Equipamentos** no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da **Ordem de Fornecimento**.

5. Comprometemos a entregar os **Equipamentos** no almoxarifado da:

a) **Secretaria Municipal de Saúde;**

MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA

CNPJ: 34.224.073/0001-89 Insc. Est.: 126522332

End.: Rua Espírito Santo, n.º 20, Bairro: Maranhão Novo, CEP: 65.903-100 Fone: (99) 3073-2687

mpmedicamentos3@gmail.com Imperatriz - MA

E-mail:





30/06/2024
028/2024

a.1) Endereço: **Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**

6. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, devidamente atestado pelo **Gestor do Contrato**, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
- b) cópia da Nota de Empenho;
- c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
- f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
- g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
- h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

7. **Responsável pela Assinatura do Contrato:** o Sr. **MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA**, CI nº 95886098-0, CPF nº 641.791.333-34.

Dados Complementares da Empresa: Telefone: (099-3073-2687), Celular: (99-99127-8214). E-mail: (mpmedicamentos3@gmail.com), Banco: (CCLA DA REGIÃO SUL DO MARANHÃO - SICREDI), Agência: 2004 - Conta Corrente: 02330-2.

Imperatriz-MA., 11 de junho de 2024.

MARCOS PAULO
SILVA
OLIVEIRA:641791
33334

Assinado de forma digital
por MARCOS PAULO
SILVA
OLIVEIRA:64179133334
Dados: 2024.06.15
10:18:15 -03'00'

MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA

CNPJ Nº 34.224.073/0001-89

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Sócio Proprietário


MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA

CNPJ: 34.224.073/0001-89 Insc. Est.: 126522332

End.: Rua Espírito Santo, n.º 20, Bairro: Maranhão Novo, CEP: 65.903-100 Fone: (99) 3073-2687

mpmedicamentos3@gmail.com Imperatriz - MA

E-mail:

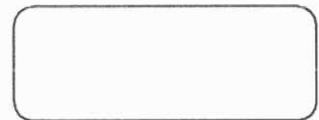

Processo nº 304
 Processo nº 078/2024
 Distribuição

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALORUNIT	VALORTOTAL
1	ANALISADOR HEMATOLOGICO 21 PARAMETROS HEMABIOIII. contador hematológico com 21 parâmetros e diferencial de 3 partes da Biotécnica, foi desenvolvido para conciliar precisão, robustez e custo-benefício. A solução ideal para laboratórios de pequeno e médio porte.	1	R\$ 62.589,31	R\$62.589,31
2	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO MODELO SMART- 200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética) Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões) Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou Turbidimetria) Hormônios (metodologia ELISA em tubos)	1	R\$ 86.700,00	R\$ 86.700,00
TOTAL GERAL				R\$ 149.289,31

Imperatriz - MA, 11 de junho de 2024

MARCOS PAULO
 SILVA
 OLIVEIRA: 64179133
 334

Assinado de forma digital
 por MARCOS PAULO SILVA
 OLIVEIRA: 64179133334
 Dados: 2024.06.15 10:18:42
 -03'00'

MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA

CNPJ Nº 34.224.073/0001-89

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Sócio Proprietário

MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA

CNPJ: 34.224.073/0001-89 Insc. Est.: 126522332

End.: Rua Espírito Santo, n.º 20, Bairro: Maranhão Novo, CEP: 65.903-100 Fone: (99) 3073-2687

mpmedicamentos3@gmail.com Imperatriz – MA

E-mail: